


Блоки подготовки воздуха

Код ОКП 41 5183



Б/1

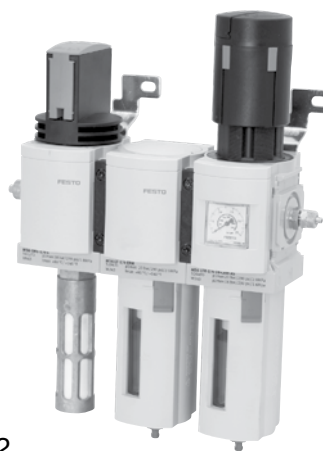

Б/2

- **Входное давление, МПа:**
максимальное 1,0 (Б/1); 1,8 (Б/2);
минимальное 0,03 (Б/1); 0,08 (Б/2)
- **Диапазон редуцированного выходного давления, МПа:**
от 0,05 до 1,0 (Б/1);
от 0,05 до 1,6 (Б/2)
- **Изменение редуцированного давления на выходе блока при изменении расхода воздуха от 0 до 100 л/мин, не более, МПа:**
0,02 (Б/1);
0,025 (Б/2)
- **Тонкость фильтрации - 5 мкм**
- **Габаритные размеры (длина x ширина x высота):**
212 x 86 x 191 мм (Б/1);
200 x 100 x 315 мм (Б/2)
- **Масса, не более, кг:**
1,06 кг (Б/1);
2,8 кг (Б/2)

Блоки подготовки воздуха Б/1 и Б/2 предназначены для очистки сжатого воздуха до класса загрязненности 1 по ГОСТ 17433, регулирования и автоматического поддержания давления сжатого воздуха, питающего пневматические приборы (калибраторы давления пневматические серии Метран-500 Воздух, контроллеры давления, грузопоршневые манометры и др.).

Блоки используются при наличии у Заказчика своей стационарной пневмосистемы подачи сжатого воздуха (и/или баллона со сжатым воздухом).

Блоки состоят из вентиля (Б/1) или клапана вкл/выкл (Б/2); фильтра предварительной очистки и фильтра-регулятора давления, оснащенного манометром для контроля выходного давления.

Блок имеет входной фитинг с ниппелем под трубку 8/6 и выходной фитинг с ниппелем под трубку 6/4. Для подсоединения к источнику сжатого воздуха в комплект входит гибкая трубка 8/6.

Пример записи при заказе:
Блок подготовки воздуха Б/2.